


Fiche d'évaluation

UnoMeter™ Safeti™ Plus

Novembre 2007

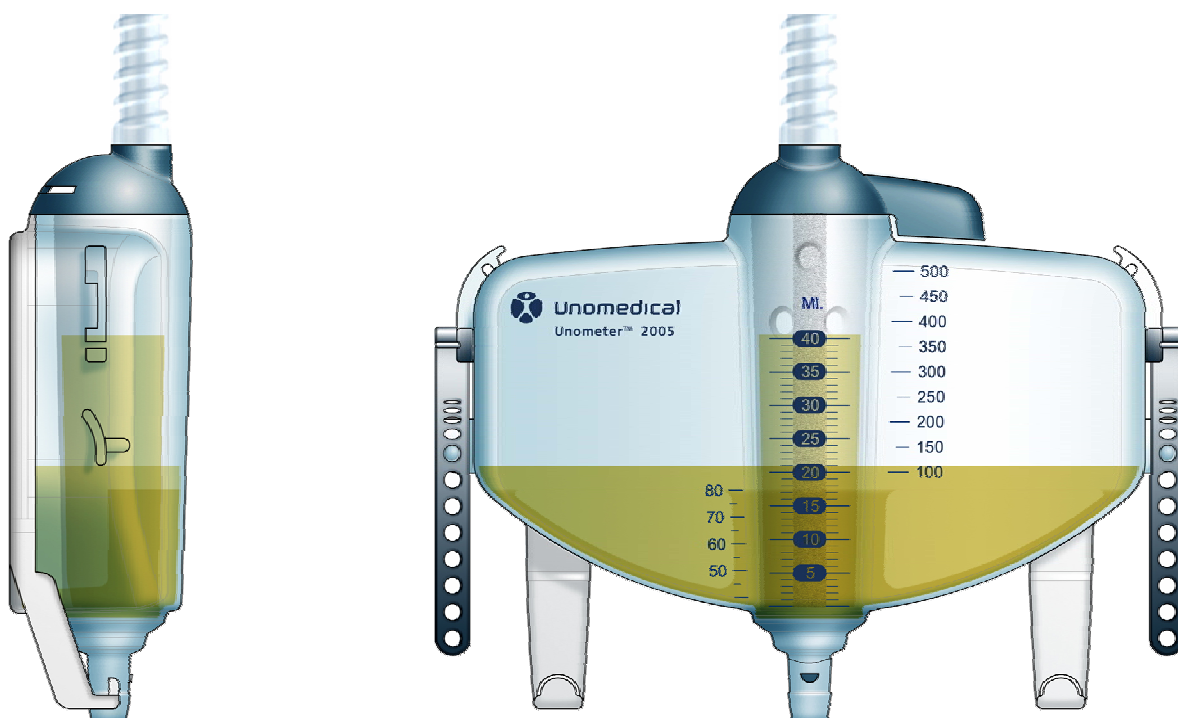

Hôpital :

Service :

Contact :

Date :


1. Le système de fixation

	<input type="checkbox"/> cordelette	<input type="checkbox"/> crochet	<input type="checkbox"/> lanières
Système de fixation	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen

2. la diurèse horaire

Lisibilité/précision de la graduation	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen
Maniabilité de la poignée de vidange	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen
Rapidité de la vidange	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen

3. La sécurité patient

<p>Deux valves anti-retour afin de minimiser le risque de contamination rétrograde ascendante</p>	<p><input type="checkbox"/> Très bien</p> <p><input type="checkbox"/> Bien</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen</p> <p><input type="checkbox"/> Très moyen</p>
<p>Spirale anti-plicature réduisant le risque de stase urinaire</p>	<p><input type="checkbox"/> Très bien</p> <p><input type="checkbox"/> Bien</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen</p> <p><input type="checkbox"/> Très moyen</p>
<p>Nouveau filtre hydrophobe 5μ protégé garantissant une ventilation constante dans le système</p>	<p><input type="checkbox"/> Très bien</p> <p><input type="checkbox"/> Bien</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen</p> <p><input type="checkbox"/> Très moyen</p> 
<p>Système compact réduisant le risque de contamination au sol</p>	<p><input type="checkbox"/> Très bien</p> <p><input type="checkbox"/> Bien</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen</p> <p><input type="checkbox"/> Très moyen</p>

4. Le site de prélèvement

Maniabilité du site de prélèvement sans aiguille KombiKon™	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen
---	--

5. Le collecteur à urine

Efficacité du robinet de vidange	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen
Ecoulement de l'urine	<input type="checkbox"/> Très bien <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Très moyen

6. Evaluation générale

Note d'évaluation générale	/ 20
-----------------------------------	-------------

Autres commentaires

Merci pour votre compréhension

Unomedical France